

Proc. 03.



Proposta Cliente : 21628

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU CE

Processo: P E 005 2020

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	255716	1	CJ	17.739,61	17.739,61
<p>REF. FÁBRICA:</p> <p>CJ CONSULTORIO D700 MOCHO STANDART FIT D700 ALLIAGE KIT ACAD S SPRAY TB</p> <p>***CADEIRA ESTRUTURA CONSTRUIDA EM ACO MACICO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPOXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXACAO NO PISO. SISTEMA TIPO PANTOGRAFICO DE ELEVACAO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO, OFERECE MAIOR RESISTENCIA, CAPACIDADE DE ELEVACAO DE ATE 200 KG. CAIXA DE LIGACAO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPACO DENTRO DO CONSULTORIO. APRESENTA O BOTAO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. BRACO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXOS COM ESTRUTURA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS DO TIPO JOYSTICK COM TRES PROGRAMACÖES DE TRABALHO COM VOLTA AUTOMATICA A POSICAO ZERO. SISTEMA DE ELEVACAO ELETROMECAÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSAO COM 24 VOLTS. SISTEMA ELETRONICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. TENSAO DE ALIMENTACAO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABECA ANATOMICO, REMOVIVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA. AMBIDESTRO</p> <p>***EQUIPO PRODUZIDO EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE / RESISTENCIA A CORROSAO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO. COMPOSICAO: SERINGA TRIPLICE / 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTACAO E 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMATICO. BRACOS ARTICULAVEIS E COM TRAVAMENTO SIMPLES, PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PECAS DE MAO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. SERINGA TRIPLICE: BICO GIRATORIO, REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL. MANGUEIRAS: ARREDONDADAS, LEVES E FLEXIVEIS. SUPORTE DAS PONTAS: COM ACIONAMENTO PNEUMATICO INDIVIDUAL. PUXADOR BILATERAL</p> <p>***UNIDADE DE AGUA PRODUZIDO EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE / RESISTENCIA A CORROSAO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO. CUBA: PROFUNDA, REMOVIVEL E COM RALO E FILTRO PARA RETENCAO DE SOLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA BASE DO SUGADOR SOB O CORPO DA UNIDADE DE AGUA. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZAO DA AGUA: PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AGUA. RESERVATORIOS TRANSLÚCIDOS DE 1000 ML PARA: AGUA DAS PECAS DE MAO E SERINGA TRIPLICE. UNIDADE DE AGUA E CUBA REBATIVEL EM 90°, POSSIBILITANDO UMA AMPLA MOBILIDADE QUE PERMITE APROXIMACAO DO AUXILIAR AO CAMPO OPERATORIO. SUCTORES: 01 SUCTOR DE SALIVA A AR (SISTEMA VENTURI) (SERIE)</p> <p>***REFLETOR HALOGENO SERIE MONOFOCAL PARA USO ODONTOLOGICO COM LAMPADA DE LUZ HALOGENA. ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING. DUPLA PROTECAO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE. PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALCA QUE POSSIBILITAM ISOLAMENTO, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINACAO CABECOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620°. INTENSIDADE: 8.000 A 25.000 LUX (TOLERANCIA +/- 20%).</p> <p>M - D700 F - ALLIAGE P - NAC RMS CADEIRA D700 10069210062 - UNIDADE AUXILIAR SYNCRUS G2 10069210063 - EQUIPO SYNCRUS G2 10069210075 - REFLETOR PERSUS L 10069210069</p>					

Handwritten signatures and initials.

VLR UNITARIO: DEZESETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS
VLR TOTAL: DEZESETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS



Proposta Cliente : 21628

Página: 2

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU CE

Processo: P E 005 2020

ITEM COD. PROD. QTDE UN. VLR. UNITÁRIO VALOR TOTAL

3 15302 2 UN REF. FÁBRICA: 8975706092 3.082,97 6.165,94
COMPRESSOR ISENTO CD TOP 7 30L BIVOLT FIAC
COMPRESSOR ISENTO DE OLEO, RESERVATORIO 30LT, VOLUME DE AR A SPIRADO
7,06PCM 200LTS/MIN, PRESSAO MAX. DE OPERACAO 120LBF/ POL, 1 CABECOTE, 1
ESTAGIO, NIVELDE RUIDO 75DBA, PINTURA INT ERNA,REGULADOR DE
PRESSAO,ACIONAMENTO DO MOTOR DIRETO DIMENSOES: 60X31X70CM PESO
28,5KG,COM VALVULA SEGURANCA GARANTIA 01 ANO POTENCIA 1,5CV, ROTACAO
1700RPM, PRTOEOR ELETRICO, BIVOLT. M-CD TOP 7/30 F-FIAC P-NAC RMS:RDC 185

VLR UNITARIO: TRÊS MIL, OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS
VLR TOTAL: SEIS MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS


4 251012 1 UN REF. FÁBRICA: 16000002351 8.519,00 8.519,00
AP RAO X S70E MOVEL 127V SAEVO
APARELHO DE RAO X S70 E DOTADO DE EXTREMA LEVEZA E COM PRECISÃO NOS
MOVIMENTOS, EXPOSIÇÕES CENTESIMAS A PARTIR 0.06 SEGUNDOS ATE 3,20
SEGUNDOS, EXCLUSIVA TECNOLOGIA GREEN COM 95% MENOS CHUMBO
CABEÇOTE CONFECCIONADO COM UM MATERIAL LEVE, COM ALTÍSSIMO GRAU DE
ISOLAÇÃO DA RADIAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO SUAVE, PRECISA, CONTROLE DIGITAL
ERGONOMICO COM CABO REMOVÍVEL COM CONTROLE CENTESIMAL DE TEMPO
ATRAVES DE MICROPROCESSADOR; SELETOR EM PAINEL LEXAN DE
ALTO-RELEVO; TODAS AS FUNCOES DO APARELHO SAO COMANDADAS PELO
CONTROLE DIGITAL, CONECTADO COM CABO ESPIRALADO DE 5 METROS. 21
INTERVALOS DE TEMPO DE EXPOSICAO PADRONIZADOS ESCALA DE ANGULAÇÃO
DO CABEÇOTE ROTAÇÃO DE 300° COM INDICAÇÃO NA PARTE TRASEIRA E
DIANTEIRA DO CABEÇOTE. NOVO SISTEMA DE ARTICULACAO DO CABEÇOTE
PROTECAO TERMICA DO CABECOTE COM CAMARA DE COMPENSAÇÃO PONTO
FOCAL COM CORRETO DIMENSIONAMENTO. CAIXA DE COMANDO EM MATERIAL
ESPECIAL COM SUPORTE DE FIXAÇÃO DO CONTROLE. BRAÇOS ARTICULÁVEIS NA
POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL. BRAÇOS E SUPORTES CONSTRUÍDOS EM AÇO,
COM CANTOS ARREDONDADOS.
TENSÃO DA REDE: 127V/60HZ / 220V/60HZ / 220V/50HZ / 230V/50HZ / 240V/50HZ
POTÊNCIA DE ENTRADA: 1200VA TENSÃO DO TUBO:70KVP CORRENTE DO TUBO:
7MA TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 60MS A 3,2S. COMPRIMENTO DO CILINDRO: 200MM
COLIMADOR RETANGULAR 30 X 40MM FILTRO EQUIVALENTE EM ALUMÍNIO: 1,5MM
DIMENSÃO DO FOCO DO TUBO: 0,8 X 0,8MM FATOR DE RESFRIAMENTO: 1:30S
M - S70E COLUNA MOVEL F - GNATUS P - NAC RMS 10069210087 DETENDOR
ALLIAGE S/A

VLR UNITARIO: OITO MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS
VLR TOTAL: OITO MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS

6 249272 1 UN REF. FÁBRICA: 21ASE 127V 4.089,15 4.089,15
AUTOCLAVE HORIZ 21L EXTRA DIGITAL 127V STERMAX
AUTOCLAVES BOX DIGITAL EXTRA 21 LITROS INSTALACAO DESCOMPLICADA;
CAMARA DE ESTERILIZACAO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304; GABINETE ACO
LAMINADO 10020; PINTURA INTERNA EXTERNA ELETROSTÁTICA PO HIBRIDA
EPÓXI POLIÉSTER PAINEL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE
TERMODINAMICO DE TEMPERATURA E PRESSAO AUTOMATICO, COM
ACOMPANHAMENTO ATRAVES DE DISPLAYS E INDICADORES LUMINOSOS; FECHO

Handwritten signatures and initials.

Proposta Cliente : 21628



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU CE

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	------------	------	-----	---------------	-------------


DA TAMPA DE TRIPLO ESTAGIO COM SISTEMA DE RESTRICAO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL; SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUCAO DUPLA TOTALMENTE EM ACO CARBONO E ACO INOX LAMINADO; GUARNICAO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CAMARA DE ESTERILIZACAO; NAO NECESSITA DE TUBULACAO PARA DRENAGEM DE AGUA; OPERACAO FACIL E AUTOMATICA QUE PERMITE A SELECAO DE DIFERENTES CICLOS; UTILIZA AGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR; SISTEMAS DE SEGURANCA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERACAO E/OU FUNCIONAMENTO; DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSAO OU FALTA DE AGUA; PRODUTO RESISTENTE, DE FACIL INSTALACAO, OPERACAO E MANUTENCAO; CICLO AUTOMÁTICO SECAGEM EXTRA PAINEL DIGITAL VÁLVULA DE ALIVIO DIÂMETRO CAMARA 252MM COMPRIMENTO DA CAMARA 421MM ALTURA EXTERNA 340MM COMPRIMENTO EXTERNO 610MM LARGURA EXTERNA 400MM PESO 29KG TENSÃO 127 OU 220V FREQUÊNCIA 50/60HZ POTENCIA CONFIGURAVEL NA FABRICA DE 500W A 5000W TEMPERATURA DE TRABALHO PADRAO OMS SET POINT 121°C DISPONIVEL EM 134°C SOB SONCULTA PREVIA PRESÃO DE TRABALHO CONFIGURAVEL NA FABRICA DE 1KGF/CM A 3 KGF/CM BANDEJAS INTERNAS 2 EM ALUMÍNIO CICLO DE SECAGEM DE SERIE 16 SISTEMAS DE SEGURANÇA
M - BOX EXTRA 21L F - STERMAX P - NAC RMS 10430810009.

VLR UNITÁRIO: QUATRO MIL, OITENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS
VLR TOTAL: QUATRO MIL, OITENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS

TOTAL DA PROPOSTA: 36.513,70
TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E SETENTA CENTAVOS
VALOR TOTAL COM DESCONTO: 36.513,70
PREGAO: ELETRONICO 005 2020

TIPO: MENOR PRECO POR ITEM
ABERTURA: 25 05 2020 AS 09:00HS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
ENTREGA: 05 DIAS
PAGAMENTO: 30 DIAS
CONTRATO: 31 12 2020

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP		
CNPJ	08.044.106/0001-07	Autorização	8.03.489-6
Produto	AUTOCLAVE ALT		

Modelo Produto Médico

AUTOCLAVE 19LD PLUS

AUTOCLAVE 19LS

AUTOCLAVE 21L

AUTOCLAVE 21L PLUS

AUTOCLAVE 21LD

AUTOCLAVE 21LD PLUS

AUTOCLAVE 21LS

AUTOCLAVE 25L

AUTOCLAVE 25L PLUS

AUTOCLAVE 25LD

AUTOCLAVE 25LD PLUS

AUTOCLAVE 25LS

AUTOCLAVE 30L

AUTOCLAVE 30L PLUS

AUTOCLAVE 30LD

AUTOCLAVE 30LD PLUS


AUTOCLAVE 30LS

AUTOCLAVE 5L

AUTOCLAVE 5L PLUS

AUTOCLAVE 5LD

Handwritten signatures and initials:
 A large signature on the right side.
 Initials 'CP' and 'J' at the bottom right.



AUTOCLAVE 5LD PLUS

AUTOCLAVE 5LS

AUTOCLAVE 65L

AUTOCLAVE 65L PLUS

AUTOCLAVE 65LD

AUTOCLAVE 65LD PLUS

AUTOCLAVE 65LS

AUTOCLAVE 7L

AUTOCLAVE 7L PLUS

AUTOCLAVE 7LD

AUTOCLAVE 7LD PLUS

AUTOCLAVE 7LS

AUTOCLAVE 80L

AUTOCLAVE 80L PLUS

AUTOCLAVE 80LD

AUTOCLAVE 80LD PLUS

AUTOCLAVE 80LS

AUTOCLAVE 100L

AUTOCLAVE 100L PLUS

AUTOCLAVE 100LD

AUTOCLAVE 100LD PLUS

AUTOCLAVE 100LS

AUTOCLAVE 12L


AUTOCLAVE 12L PLUS

AUTOCLAVE 12LD

AUTOCLAVE 12LD PLUS

AUTOCLAVE 12LS

AUTOCLAVE 19L



A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020


OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CARTA PROPOSTA

Prezados (a) senhores (a);

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste pregão, acatando todas as estipulações consignadas no edital, conforme abaixo:

Item	Descritivo, Modelo, Marca, Fabric., Proced. e RMS	Und.	Qte.	Valor Unit.	Valor Total
2	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA PEDAL, CABECEIRA, REFLETOR, EQUIPO ACOPLADO, TERMINAIS DE NO MINIMO 03, CUBA: PORCELANA / CERÂMICA, SERINGA TRÍPLICE, PEÇA RETA, CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR, UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR), CANETA DE ROTAÇÃO, MOCHO "Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integra da especificação do edital, conforme segue: 1. Cuba Porcelana/ Cerâmica (Unidade Auxiliar) 2. Mocho Magnus Prata Anatômico 3. 01(Uma) Caneta de Alta Rotação Prime CX207 PB - RMS: 80349600009 4. 01(Um) Micromotor Prime Cx235 (Refrigeração externa) - RMS: 80349609006 5. 01(Um) Contra Ângulo Prime Cx235 (Refrigeração externa) - RMS: 80349609005 6. 01(Uma) Peça Reta Prime Cx235 (Refrigeração externa) - RMS: 80349609007 COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600007 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"	und	01	R\$ 17.740,00 (DEZESSETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS)	R\$ 17.740,00 (DEZESSETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS)



03	<p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTÊNCIA / CONSUMO: OPÇÃO 1: 30 A 39L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS. OPÇÃO 2: 40 A 49L/1 A 2HP/7 A 8 PÉS. OPÇÃO 3: 50 A 69L/1,5 A 2,5HP/8 A 12 PÉS. OPÇÃO 4: 70 A 100L/2 A 2,5HP/12 PÉS. ISENTO DE ÓLEO</p> <p>MODELO: PRIME AIR 40 - G2 MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</p>	und	02	R\$ 3.083,00 (TRÊS MIL, OITENTA E TRÊS REAIS)	R\$ 6.166,00 (SEIS MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS)
04	<p>APARELHO DE RAIOS X — ODONTOLÓGICO COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL OU PANTOGRÁFICO; PAREDE COM BRAÇO CONVENCIONAL OU PANTOGRÁFICO. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL TENSÃO: MÍNIMO 7MA</p> <p>MODELO: ION 70 X - MOVEL OU PAREDE MARCA: PROCION FABRICANTE: PROCION PROCEDENCIA RAIOS-X NACIONAL REGISTRO NA ANVISA: 80127670002</p>	und	01	R\$ 8.519,00 (OITO MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS)	R\$ 8.519,00 (OITO MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS)
06	<p>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 25 LTS CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE/ACESSÓRIOS: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS! NÃO POSSUI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opção 1: ANALÓGICO/ ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI - Opção 2: ANALÓGICO/ DE 26 A 45 LITROS/ NÃO POSSUI - - Opção 3: DIGITAL/ ACIMA DE 46 LITROS/ NÃO POSSUI - Opção 4: DIGITAL! ATÉ 25 LITROS! IMPRESSORA - Opção 5: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS! NÃO POSSUI - Opção 6: DIGITAL/ DE 26 A 45 LITROS/ NÃO POSSUI <p>MODELO: AUTOPRIME 21 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED (INOVA INOX) PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600006</p>	und	01	R\$ 6.607,00 (SEIS MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS)	R\$ 6.607,00 (SEIS MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS)


VALOR TOTAL PROPOSTA: R\$ 39.032,00
(TRINTA E NOVE MIL, TRINTA E DOIS REAIS)

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Validade da proposta:	60 (sessenta) Dias - CONFORME EDITAL
Condições de pagamento	30 (trinta) Dias - CONFORME EDITAL
Prazo de entrega:	05 (cinco) Dias - CONFORME EDITAL
Local de entrega:	CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME EDITAL
Frete / impostos:	INCLUSOS
Assistência técnica	EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO – CONFORME EDITAL.

Autoclave Horizontal

Auto Prime 21

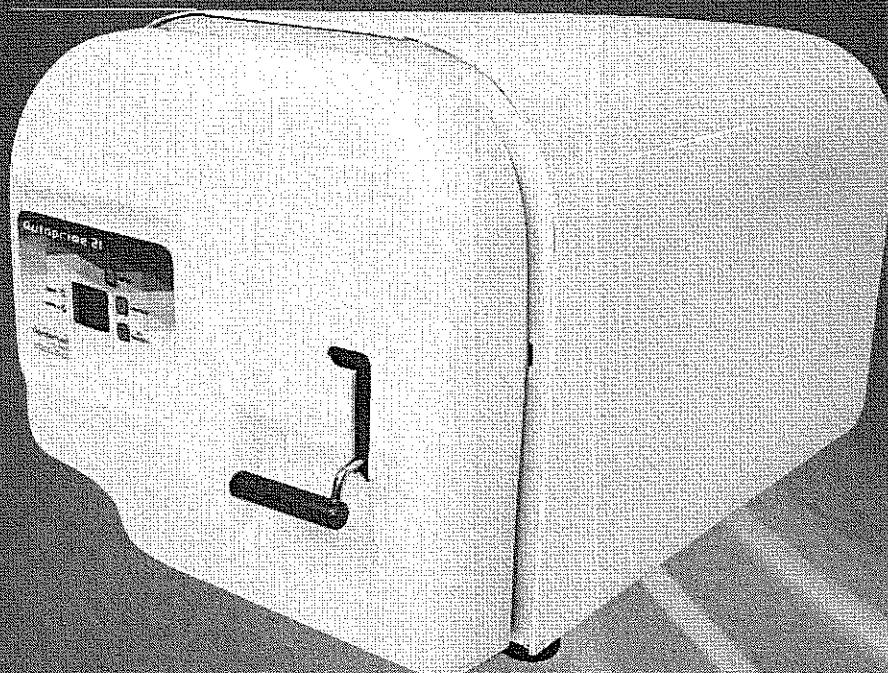

Câmara: Aço inox com Capacidade de 21 Litros

Potência: 1.960 Watts / Tensão de Alimentação: 127 ou 220 VCA - 50/60 Hz

Bandejas: 02 ou 03 bandejas em alumínio.

Garantia: 01 ano

Registro ANVISA: 80349600006

Vaso de Pressão/Tanque Inox certificado conforme a Portaria do INMETRO 255 (29/05/2014). Nº de Certificado 005.2019.VPS.02.

Construída com tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza, pintura na cor branca com teclado de controle na cor azul. Programação com 10 ciclos. Secagem com porta fechada. Sistema com microcontrolador. 21 sistemas de segurança, que possibilita maior desempenho do equipamento, mais comodidade e segurança ao operador. Acompanha suporte, copo graduado, mangueira para descarte de condensado. Ideal para consultórios odontológicos (clínica geral e demais especialidades) e consultórios médicos (dermatologia e oftalmologia).

A Autoclave Auto prime 21 é fabricada pela Dentemed Equipamentos Odontológicos, empresa brasileira fabricante e importadora de produtos para a saúde. A Dentemed possui um Sistema de Gestão da Qualidade certificado nas normas NBR ISO 9.001 e NBR ISO 13.485, atendendo todos os requisitos da RDC 16/2013 - BPF ANVISA.

Dentemed

Dentemed Equipamentos odontológicos Ltda.

Rua Antônio Gravatá, nº. 136 A, Bairro Betânia, Belo Horizonte, MG

CEP: 30.570-040 - Telefone: (31) 3374-6768/ 3377-7500

www.dentemed.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE.

Abertura das Cartas Propostas: Início: 25 de Maio de 2020 às 09h00min (Horário de Brasília)

Sessão de Disputa de Lances: Início: 25 de Maio de 2020 às 09h00min (Horário de Brasília)

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UNIDADE	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
6	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA – ATE 75 LITROS CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE/ACESSÓRIOS: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI - Opção 1: ANALÓGICO/ ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI - Opção 2: ANALÓGICO/ DE 26 A 45 LITROS/ NÃO POSSUI - Opção 3: DIGITAL/ ACIMA DE 46 LITROS/ NÃO POSSUI - Opção 4: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/ IMPRESSORA - Opção 5: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI - Opção 6: DIGITAL/ DE 26 A 45 LITROS/ NÃO POSSUI.	1	UND	STERMAX	R\$ 6.607,00	R\$ 6.607,00
TOTAL						R\$ 6.607,00

seis mil, seiscentos e sete reais

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 6.607,00
seis mil, seiscentos e sete reais

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS ÚTEIS

DECLARAMOS que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação.

DECLARAMOS que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

DECLARAMOS QUE NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, SÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS total concordância com os termos do Edital.

25/05/2020

LOCAL, 25 DE MAIO DE 2020.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Secretaria de Saúde
Comissão de Licitação



OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020

ABERTURA: 25 / 05 / 2020 ÀS 09 : 00 H

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)

ITEM 6

6	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - ATÉ 75 STERMAX LITROS. CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO. AÇO INOXIDÁVEL. MODO DE OPERAÇÃO / CAPACIDADE / ACESSÓRIOS: DIGITAL / ATÉ 25 LITROS / NÃO POSSUI. OPÇÃO 1: ANALÓGICO / ATÉ 25 LITROS / NÃO POSSUI; OPÇÃO 2: ANALÓGICO/ DE 26 A 45 LITROS / NÃO POSSUI; OPÇÃO 3: DIGITAL / ACIMA DE 46 LITROS / NÃO POSSUI OPÇÃO 4: DIGITAL / ATÉ 25 LITROS / IMPRESSORA OPÇÃO 5: DIGITAL / ATÉ 25 LITROS / NÃO POSSUI OPÇÃO 6: DIGITAL / DE 26 A 45 LITROS / NÃO POSSUI		1	UND	8.589,10	8.589,10
---	--	--	---	-----	----------	----------

8.589,10

oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e dez centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$	8.589,10
oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e dez centavos	

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do PRAZO DE ENTREGA: Até 05 (cinco) dias Conforme edital

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitada, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).